



DIRECTION ENERGIE NUCLEAIRE
 DIRECTION DU CENTRE DE SACLAY
 DEPARTEMENT DES REACTEURS ET
 DES SERVICES NUCLEAIRES
 SERVICE D'EXPLOITATION ORPHEE

REACTEUR ORPHEE
INB N° 101

NOTE TECHNIQUE SPECIFIQUE

Ind. A

Page 4/35

CEA/DEN/DANS/DRSN/SOR
 DO 32 27/01/11



11MMMT000041


diffusé le : 27/01/11

AM 902 Nr 002

POSTE EXPERIMENTAL : 1 T 1 Tél. : 2.62.28
 TYPE DU SPECTROMETRE : 3 AXES
 ETUDES REALISEES : DIFFUSION INELASTIQUE
 RESPONSABLE : D. LAMAGO Tél. : 2.96.88
 ASSISTANT TECHNIQUE : C. MEUNIER Tél. : 2.66.90
 SPR (Tél.) : 2.33.74 ou 2.28.84
 SALLE DE CONDUITE ORPHEE (Tél.) : 2.43.06
 2.28.88

DANGERS CONNUS	MESURES PREVENTIVES EXISTANTES	ACTIONS D'URGENCE
Rayonnements ionisants		Fermer le barillet. Prévenir le SPR et la salle de conduite ORPHEE.
Electricité		Déclencher l'interrupteur coup-de-poing.
Inondation	Isolement automatique des circuits d'eau de refroidissement.	Isoler les circuits avec les vannes manuelles. Prévenir la salle de conduite ORPHEE.

SPECTROMETRE A 3 AXES 1T1

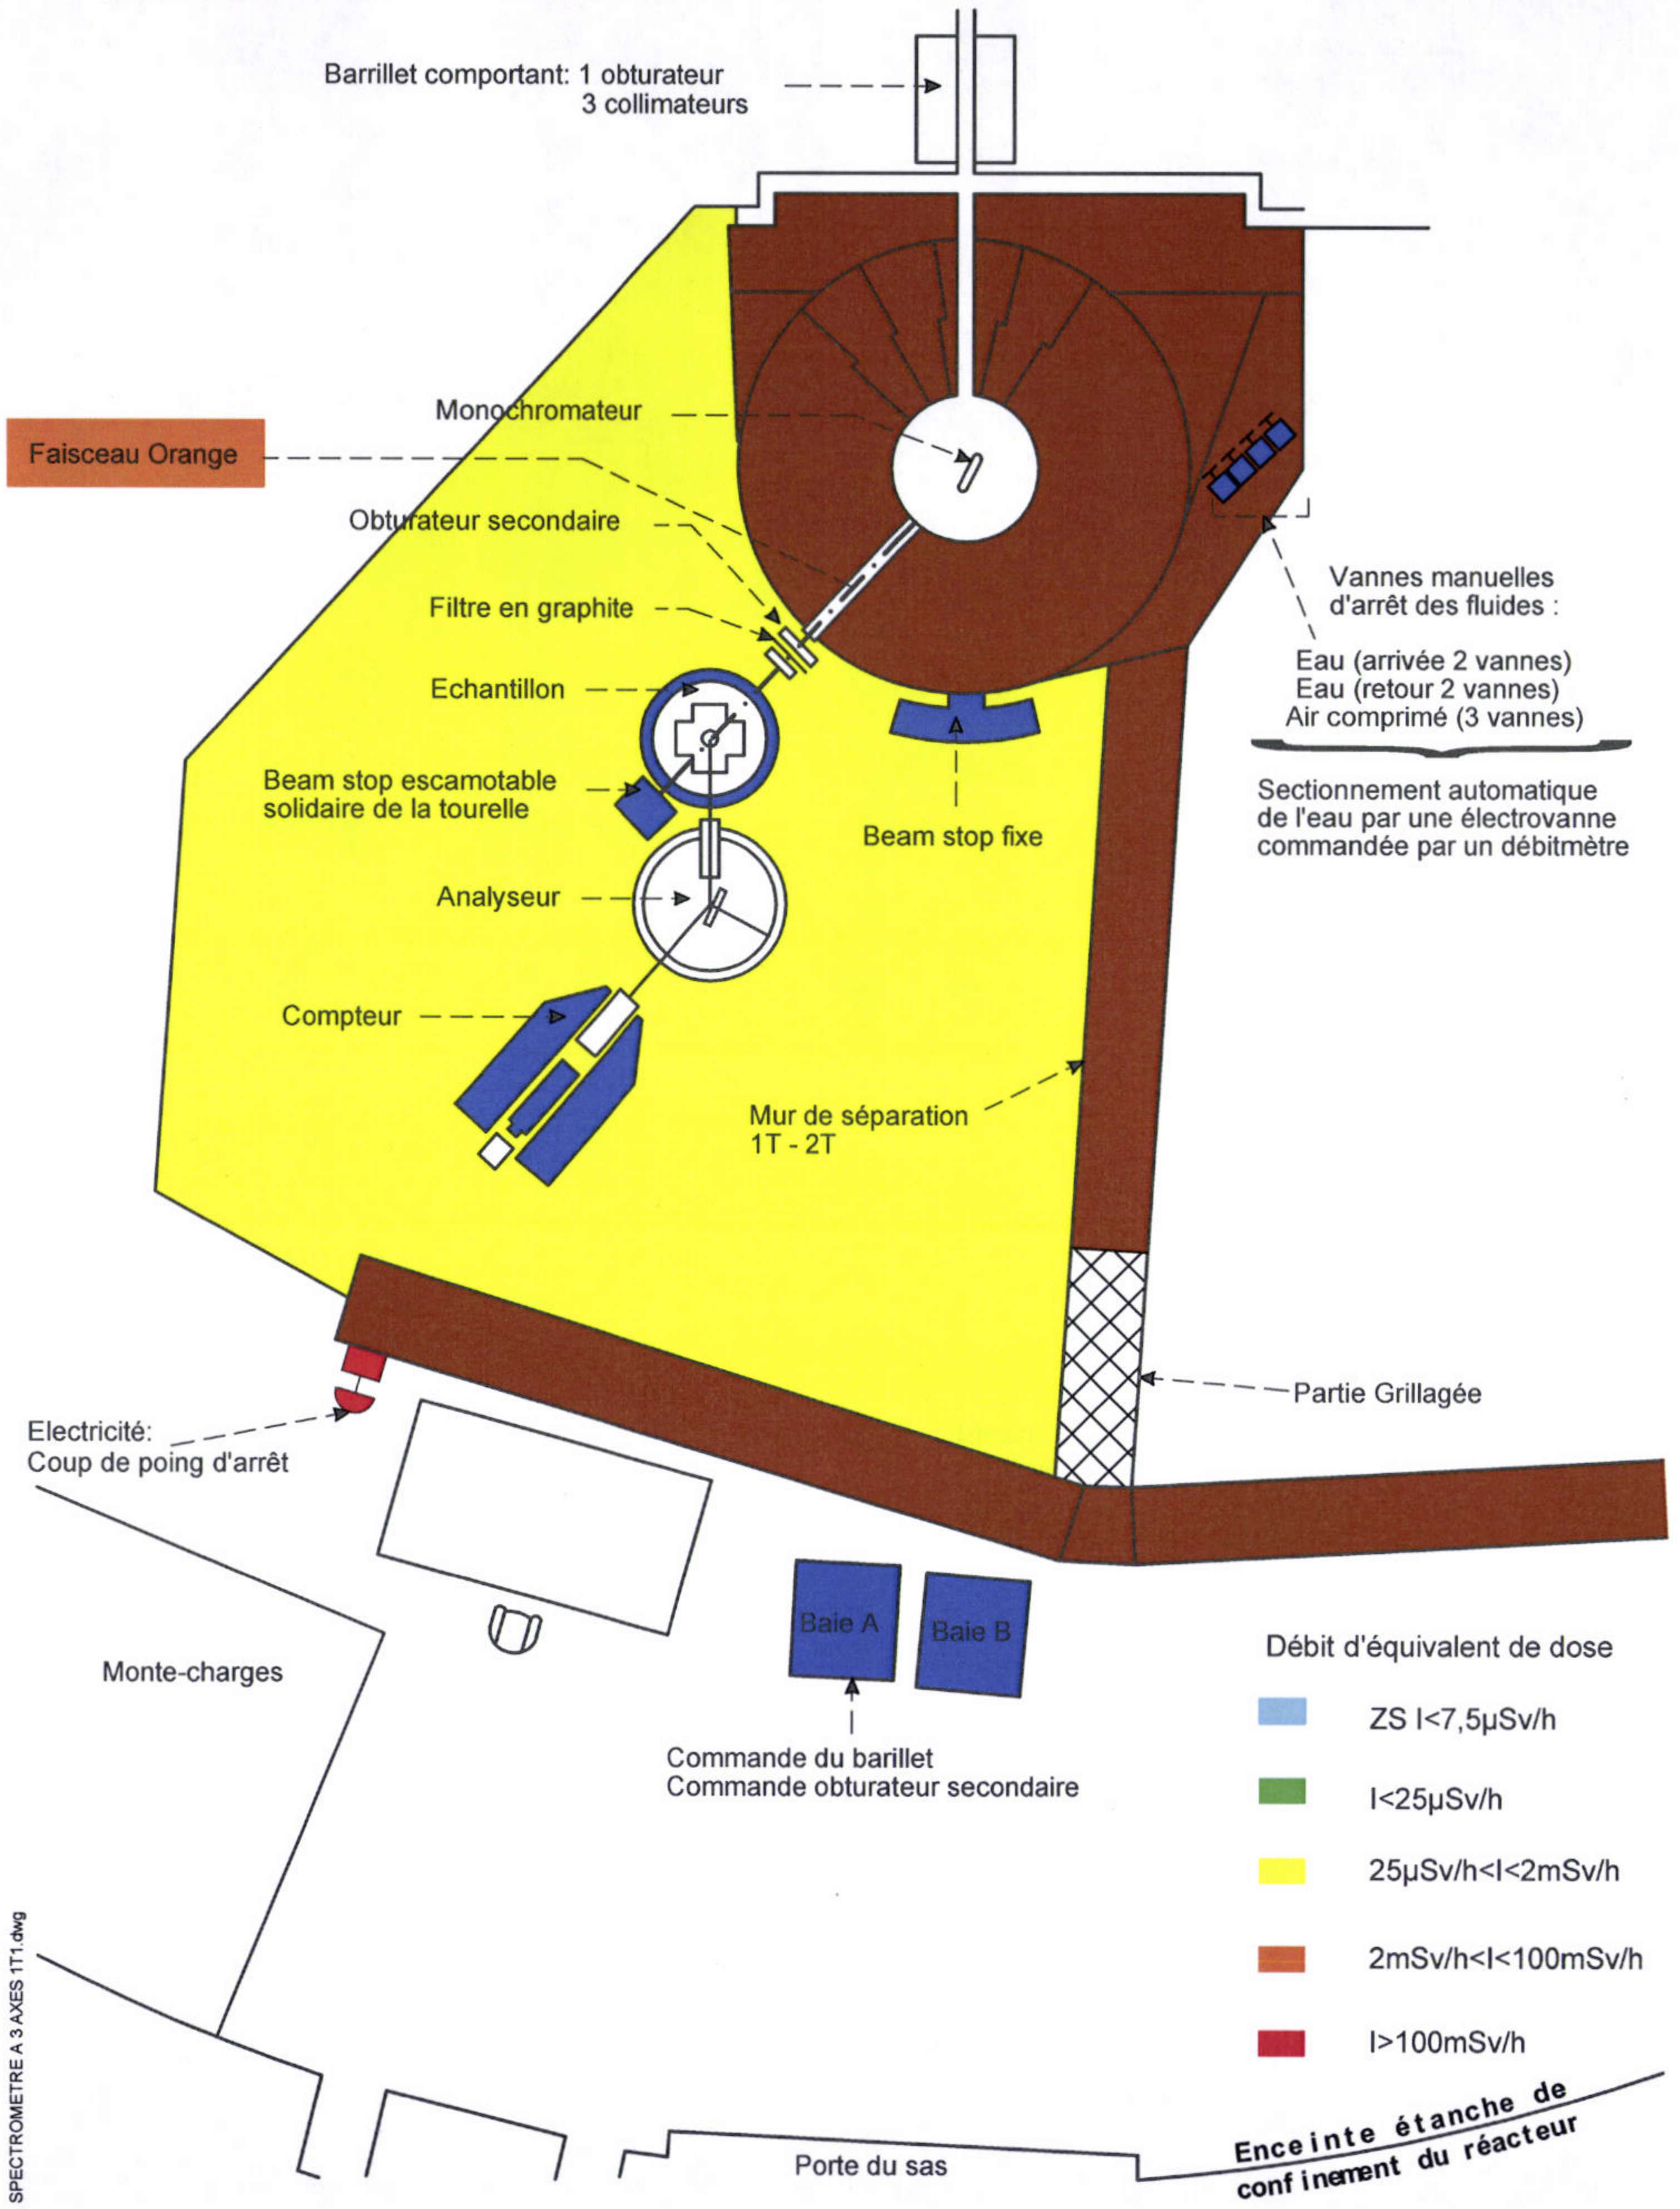

Débit d'équivalent de dose

■	ZS I < 7,5 μSv/h
■	I < 25 μSv/h
■	25 μSv/h < I < 2 mSv/h
■	2 mSv/h < I < 100 mSv/h
■	I > 100 mSv/h